




HCl - April 2019

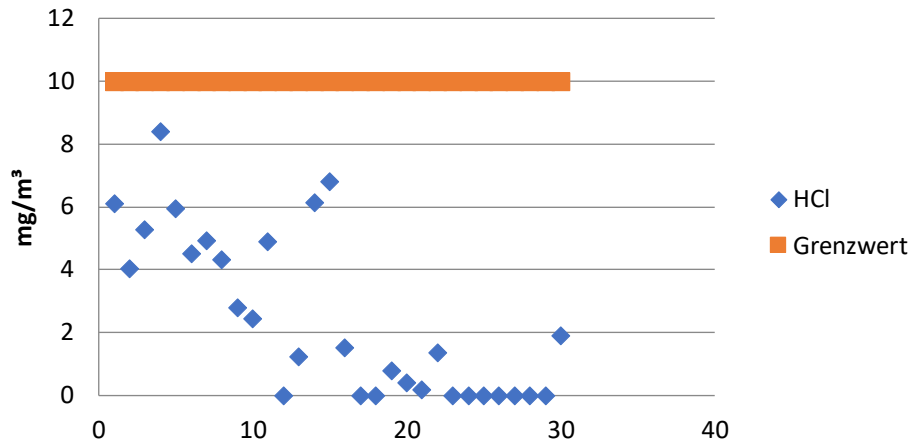

Gesamtstaub - April 2019

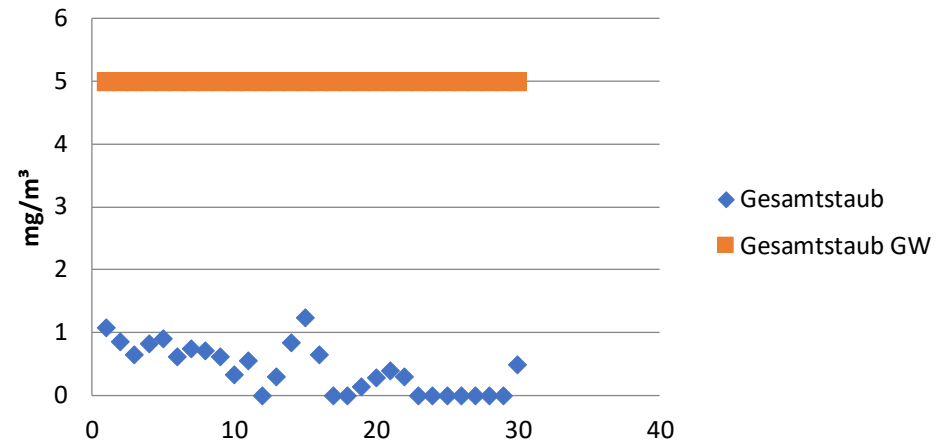

Verbrennungsbedingungen - April 2019

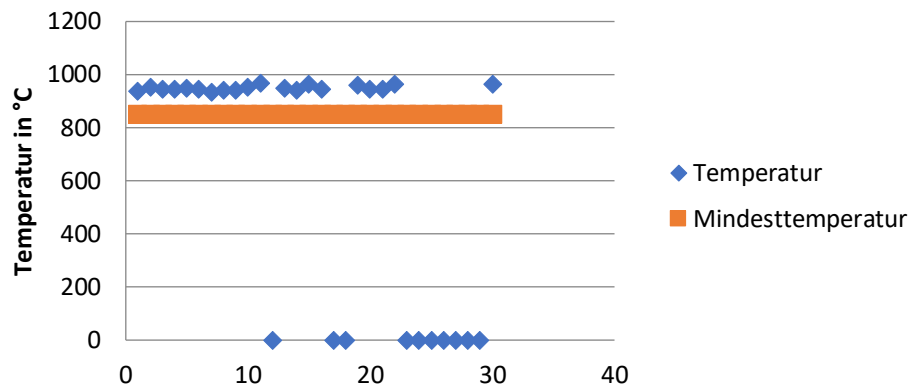

Verfügbarkeit der Messtechnik lt. DURAG data systems: 99,98%